

Manuel d'instructions pour le FloorBed 2 et le FloorBed 2 Junior

IFU-FL2-002FR Rév 05

Table des matières

Titre	Page
Bienvenue	2
1. Moyen de livraison	5
2. Consignes de sécurité	5
3. Environnements d'utilisation	5
4. Utilisation prévue	5
5. Spécification technique	6
6. Accessoires	6
7. Spécification électrique	7
8. Assemblage	7
9. Commandes et indicateurs du lit	9
10. Fonction « sol »	11
11. Contrôle des fonctionnalités	11
12. Utilisation des freins des roulettes	12
13. Sélection du matelas	12
14. Sélection des barrières latérales	12
15. Démontage	12
16. Déplacement et repositionnement	13
17. Nettoyage et désinfection	13
18. Dépannage	14
19. Stockage	14
20. Inspection quotidienne	14
21. Entretien général	14
22. Garantie	14
23. Élimination	14
24. Déclaration CEM	15
25. Tableau des symboles	19
26. Coordonnées	19

Translated from IFU-FL2-002EN Rev 05

Politique de conception et propriété intellectuelle

® Et ™ sont des marques commerciales appartenant à Accora Ltd, sauf indication contraire. Appliquant une politique d'amélioration continue, nous nous réservons le droit de modifier les conceptions sans préavis. © Accora Ltd 2020.

Bienvenue

Cher/chère client(e),

Merci d'avoir acheté un produit de santé Accora. Avant d'utiliser le lit, vous devez lire et comprendre toutes les instructions de ce manuel. Toute utilisation ou manipulation du lit doit être effectuée conformément aux instructions de ce manuel.

Veuillez vous assurer que le manuel est à la disposition des utilisateurs et des opérateurs pendant toute la durée de vie du lit.

Contactez-nous si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. Voir la section 26 pour les coordonnées de contact spécifiques par région.

Avant d'utiliser le lit, vous devez lire et comprendre toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Toute utilisation ou manipulation du lit doit être effectuée conformément aux instructions de ce manuel.

Toute action incompatible avec le manuel est effectuée à vos propres risques et Accora ne sera pas responsable de toute blessure ou dommage. Veuillez vous assurer que le manuel est à la disposition des utilisateurs et des opérateurs pendant toute la durée de vie du lit.

Général

Le FloorBed 2 est classé comme un dispositif médical de classe 1 conformément au Règlement européen sur les dispositifs médicaux 2017/745.



Avis aux utilisateurs

Si un incident grave se produit en rapport avec ce dispositif médical, affectant l'utilisateur ou le patient, alors l'utilisateur ou le patient doit signaler l'incident grave au fabricant (ou distributeur) du dispositif médical et, dans l'Union européenne, l'utilisateur doit également signaler l'incident grave à l'autorité compétente de l'État membre où il se trouve.



Accora Ltd, 38 Main Street,
Swords, Co. Dublin, Irlande, K67 E0A2
T : +353 (0)1 695 0614

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

1. Conservez ce manuel d'instructions pour référence ultérieure.
2. Ces instructions doivent être respectées pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce lit et la sécurité des utilisateurs et des soignants.
3. Ce lit doit être assemblé, positionné et utilisé conformément à ces instructions.
4. Les dispositifs de sécurité pour le fonctionnement du lit et les instructions concernant le lit doivent être strictement respectés.
5. Ce lit ne doit pas être exposé à la fumée, aux flammes nues, aux températures extrêmes, aux gaz inflammables ou à d'autres substances ou situations dangereuses.
6. Accora ne peut être tenu responsable des dommages, blessures ou accidents résultant de modifications non autorisées, de pièces de rechange non authentiques, de négligence ou d'une utilisation non conforme à ce manuel pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles.
7. L'équipement électrique peut être dangereux s'il est mal utilisé ou utilisé avec exagération. Assurez-vous que le câble d'alimentation électrique n'est pas endommagé par écrasement et ne crée pas de risque de trébuchement.
8. N'utilisez que des barrières latérales et autres accessoires compatibles avec ce lit fournis par Accora. Des barrières latérales incompatibles peuvent entraîner des dangers et le patient risque de s'y coincer.
9. Tenez les enfants (autres que le patient) et les animaux domestiques éloignés de ce lit, sauf sous la surveillance d'un adulte, car il existe un risque de blessure et/ou d'étouffement avec les petites pièces.
10. N'abaissez pas le lit lorsqu'un treuil s'étendant sous le lit est utilisé. Vous pouvez accéder au treuil lorsque le lit est élevé à 45 cm, du sol à la base du sommier.
11. Lors du raccordement d'autres équipements électroniques utilisés avec le lit (par exemple, une pompe à matelas pneumatique), assurez-vous que les câbles ne peuvent pas être pincés, écrasés ou endommagés par la barre de protection murale.
12. La commande manuelle doit être positionnée de manière à éviter tout risque d'étranglement. Une utilisation inappropriée de la commande manuelle (par ex. pliage, cisaillement) peut entraîner des risques électriques dangereux. Le lit ne doit pas être utilisé en cas de dommages visibles sur la télécommande ou le câble.
13. Ne vous tenez jamais debout sur le lit.
14. Une utilisation inappropriée du câble d'alimentation (par ex. pliage, cisaillement) peut entraîner des risques électriques dangereux. Le lit ne doit pas être utilisé s'il y a des dommages visibles sur ce câble.
15. Un acheminement inapproprié des câbles d'accessoires, par exemple le câble de la pompe à air du matelas, peut entraîner des risques électriques dangereux s'ils sont coincés ou écrasés entre des pièces mobiles. Le lit ne doit pas être utilisé en cas de dommages visibles aux câbles.
16. Le lit doit être laissé au niveau du sol lorsque le patient est sans surveillance afin de réduire les risques de blessures en cas de chute.
17. Si l'utilisation des fonctions électroniques nuit à la santé du patient, débranchez l'alimentation électrique et n'utilisez le lit qu'en mode statique.
18. Ne déplacez pas le lit lorsqu'il est au niveau du sol.
19. Ce lit ne doit pas être utilisé pour transporter des patients, notamment dans des véhicules.
20. Ce lit n'est pas recommandé pour les utilisateurs en dehors des spécifications de poids et de taille détaillées dans la section 4
21. Ne modifiez pas ce lit sans l'autorisation d'Accora.
22. Avant d'utiliser ce lit, assurez-vous que le patient est positionné en toute sécurité pour réduire les risques de chute et de déséquilibre et éviter que le patient ne soit coincé dans le mécanisme.
23. Vérifiez systématiquement qu'il n'y a aucun obstacle sous le lit avant de l'abaisser au niveau du sol.
24. Les installations électriques doivent répondre aux exigences locales.
25. Les patients, ou les utilisateurs, doivent subir une évaluation des risques pour s'assurer qu'ils sont capables de comprendre ce manuel et d'utiliser le FloorBed en toute sécurité sans risque pour eux-mêmes ou pour les autres.
26. Les patients ou utilisateurs ne doivent être autorisés à faire fonctionner le lit de manière indépendante uniquement s'ils sont capables de comprendre les consignes de sécurité de ce manuel et s'ils ont subi une évaluation des risques appropriée pour ce faire.
27. Si le poids combiné du matelas et des accessoires dépasse 35 kg, le poids maximum autorisé pour le patient doit être réduit en conséquence.
28. Le lit ne convient pas aux patients qui mordent ou mâchent du tissu.
29. L'équipement près du lit ou attaché à celui-ci peut représenter un danger, notamment en coinçant le patient ou en le faisant trébucher.

FloorBed 2 (NSB-0-FL2-200)

Lit de soins infirmiers adapté aux patients adultes



FloorBed 2 Junior FloorBed 2 Junior (NSB-0-FL2-200 + Pare-chocs pour tête et pied de lit BMHNE-0-FL4-500 + Manchon de sécurité SLE-0-FL4-100 + Plaque de protection PROPL-0-FL4-500)
Lorsque le pare-chocs pour tête et pied de lit, le manchon de sécurité et la plaque de protection sont montés sur le FloorBed 2, le lit est adapté aux patients enfants de plus de 75 cm.
Les manuels d'instructions suivants doivent être lus en plus de ce manuel d'instructions :

- IFU-FL2-005FR Pare-chocs pour tête et pied de lit
- IFU-FL1-012EN Manchon de sécurité
- IFU-FL2-006EN Plaque de protection



1

Pare-chocs pour tête et pied de lit
BMHNE-0-FL4-500

2

Manchon de sécurité
SLE-0-FL4-100

3

Plaque de protection (sous le manchon)
PROPL-0-FL4-500

1. Moyens de livraison

AVERTISSEMENT

Une extrême prudence doit être prise lors du déplacement du lit sur le support de transport pour éviter que le lit ne bascule ou ne bouge de manière inattendue.

Le lit est fourni sur un support de transport. Une inspection doit avoir lieu à la réception pour s'assurer que la livraison est complète et non endommagée.

Toute pièce manquante, tout défaut ou dommage doit être signalé immédiatement au transporteur et à Accora par écrit.

Lors du chargement et du déchargement, il faut veiller à ce que les roulettes du support de transport puissent tourner librement et que les freins des roulettes soient déverrouillés. Ces roulettes sont conçues pour être utilisées dans un environnement intérieur et pour se déplacer sur des sols réguliers, lisses et propres (par exemple, carreaux de sol en céramique, linoléum, planchers moulés). Les roulettes peuvent être endommagées en déplaçant le lit le long d'une surface rugueuse, inégale ou sale.

2. Consignes de sécurité

1. Avant d'utiliser le lit, vous devez lire le manuel d'instructions et utiliser le lit conformément à celui-ci.
2. Le lit ne doit pas être utilisé si des défauts y ont été détectés pouvant causer des blessures au patient, au personnel ou à une tierce personne ou à l'environnement.
3. Le lit ne doit être utilisé que par des personnes capables de l'utiliser conformément au manuel.
4. Le personnel doit sensibiliser le patient aux fonctions de contrôle qui s'appliquent au patient soumis à une évaluation par un professionnel.
5. Avant d'utiliser le lit, l'opérateur doit comprendre le lit et ses fonctionnalités.
6. La charge de travail de sécurité, telle que spécifiée dans la section 4, ne doit jamais être dépassée.
7. S'il y a un patient sur le lit, les roulettes du lit doivent être verrouillées car une roulette de lit déverrouillée peut entraîner des blessures si le patient se lève ou change de position.
8. La hauteur du sommier doit être ajustée à la bonne hauteur en fonction de l'état du patient.
9. Une seule personne doit occuper le lit à la fois.
10. Lors de l'utilisation des parties mobiles du lit, veillez à ce que ni le patient, ni d'autres personnes ou objets ne soient coincés.
11. Si une perche de levage ou un support de perfusion est fixé au lit, il faut faire très attention, lors du déplacement, du levage ou du basculement, à l'espace autour de la perche de levage et du pied

de perfusion, afin de ne pas endommager l'équipement.

12. Avant de nettoyer le lit, l'alimentation électrique doit être débranchée.
13. Le lit ne doit pas être utilisé en cas de danger d'explosion ou en présence de liquides inflammables non contenus.
14. Lors de la réparation du lit, seuls les matériaux et les composants d'origine doivent être utilisés. Dans le cas contraire, le fabricant ne peut pas garantir l'absence de dommages suite à cette action.

3. Environnements d'utilisation

Ce lit est destiné à être utilisé dans les environnements suivants :

1. Environnement d'utilisation 3 - Soins de longue durée dans une zone médicale où une surveillance médicale est requise et assurée si nécessaire et un équipement utilisé dans les procédures médicales peut être fourni pour aider à maintenir ou à améliorer l'état du patient. Notez que cela inclut l'utilisation dans les maisons de soins infirmiers et dans les établissements de réadaptation et de gériatrie.
2. Environnement d'utilisation 4 - Soins dispensés dans un espace domestique où des équipements sont utilisés pour soulager ou compenser une blessure, un handicap ou une maladie.

4. Utilisation prévue

Sous réserve d'une évaluation des risques, le lit peut contribuer à maintenir, améliorer, compenser ou alléger l'état du patient.

Description	Groupe d'utilisateurs
FloorBed 2 NSB-0-FL2-200	Patients adultes Hauteur minimale : 146 cm
Le FloorBed 2 Junior comprend : FloorBed 2 NSB-0-FL2-200 + Pare-chocs pour tête et pied de lit BMHNE-0-FL4-000 + Manchon de sécurité SLE-0-FL4-000 + Plaque de protection PROPL-0-FL4-500	Patients enfants Hauteur minimale : 75 cm Hauteur maximale : 155 cm

Lorsqu'il est équipé d'une housse de sécurité et d'un pare-chocs, le lit convient aux patients enfants comme indiqué dans le tableau ci-dessus. Ces pièces doivent être montées conformément à leur instructions d'utilisation.

Une évaluation des risques doit être effectuée avant que le lit ne soit utilisé par un patient.

Il est essentiel de consulter Accora à l'avance si vous souhaitez utiliser le lit à des fins autres que celles décrites dans ce manuel. Les installations électriques doivent répondre aux exigences locales. Il est recommandé que le lit soit déconnecté du secteur dans des cas exceptionnels (notamment en cas de tempête).

5. Spécifications techniques


Informations environnementales :

Condition	Plage de températures	Humidité relative	Pression atmosphérique
Utilisation	- 10°C à + 40°C + 50 °F à + 104 °F	30 % à 75 % (Sans condensation)	700 hPa à 1 060 hPa
Transport/ stockage	- 20 °C à + 50 °C - 4 °F à + 122 °F		

Si le lit est stocké dans des conditions hors de la plage de fonctionnement normale, il faut lui laisser le temps de se stabiliser, dans des conditions de fonctionnement normales, avant de l'utiliser.


Description	Valeur
Dimensions globales	935 mm de large x 2285 mm de long (36,8 pouces de large x 90,0 pouces de long)
Dimensions du sommier *	900 mm de large x 2000 mm de long (35,4 pouces de large x 78,7 pouces de long)
Roulette de lit	4 x 75 mm avec frein (4 x 3 pouces avec frein)
Hauteur du sommier	71 mm à 800 mm (2,8 pouces à 31,5 pouces)
Charge maximale de levage de la perche auto-assistée	75 kg (12st) (165 lb)
Charge de travail de sécurité**	185 kg (29st) (408 lb)
Poids maximal du patient**	150 kg (24st) (330 lb)
Bruit audible	<60 dBA
Masse du lit (hors support de transport)	93,2 kg (14.5st) (205 lb)
- Tête de lit	26,5 kg (4st) (58,5 lb)
- Pied de lit	26,5 kg (4st) (58,5 lb)
- Sommier, côté tête	23,0 kg (3,5st) (50 lb)
- Sommier, pied du lit	17,2 kg (2,7st) (38 lb)
Protection contre la pénétration de liquides	IPX4
Fonction Trendelenburg	15 degrés
Durée de vie	Généralement 5 ans

Gamme de sommier du FloorBed incluant les angles maximum :

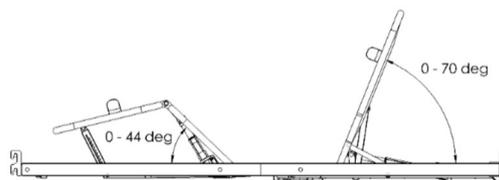

Parties clés du lit :

- 1 Tête de lit
- 2 Pied de lit
- 3 Sommier, côté tête
- 4 Sommier, côté pied

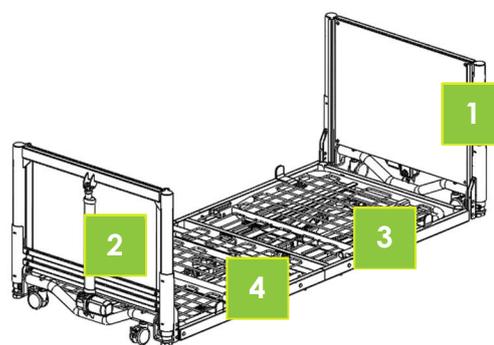

* La taille recommandée pour un patient est de 1,46 – 1,85 mètre. Les patients plus grands utiliser une extension de sommier. Voir la Section 12.

** La charge de travail de sécurité est calculée comme suit (comme spécifié par la norme EN 60601-2-52) :

Poids maximal du patient :	150 kg	24 st	330 lb
Matelas	20 kg	3 st.	44,5 lb
Accessoires	15 kg	2 st	33,5 lb
TOTAL (Charge de travail de sécurité)	185 kg	29 st	408 lb

6. Accessoires

Numéro de modèle	NSB-0-FL2-200
Barrières latérales - 2000 mm / 78,7 pouces	SDR-0-FL2-100
Barrières latérales - 2200 mm / 86,6 pouces	SDREX-0-FL2-100
Barrières latérales avec traverse latérale - 2000 mm / 78,7 pouces	SDR-0-FL4-500
Extension de sommier – 100 mm / 4,0 pouces	LRPEX-0-FL1-200
Extension de sommier – 200 mm / 7,9 pouces	LRPEX-0-FL1-100
Levier pour lit standard	STLEV-0-FL1-100
Levier pour lit rotatif	RTLEV-0-FL1-000
Tige de levage auto-assistante trapézoïdale	LIFOL-0-FL1-000
Pare-chocs pour tête et pied lit avec poche de verrouillage pour la télécommande	BMHNE-0-FL4-500
Manchon de sécurité	SLE-0-FL4-100
Plaque de protection	PROPL-0-FL4-500

7. Spécification électrique

Cycle de service : Fonctionnement intermittent 2 min/18 min ; cela implique qu'après l'action continue maximale de deux minutes, il doit y avoir une pause de 18 minutes.

Numéro de modèle	NSB-0-FL2-200
Tension d'alimentation	100 - 240V
Fréquence d'alimentation	50/60 Hz



Le symbole B indique que ce produit a un degré de protection contre les chocs électriques pour les équipements de type B.



Lisez le manuel avant l'utilisation.

IPX4

Degré de protection contre la pénétration de liquide.



Ne pas jeter avec les déchets ménagers.



Degré de protection contre les chocs électriques : Classe II Double Isolation.



Pour usage intérieur seulement

Pour une liste complète et une explication des symboles utilisés, voir la section 24.

8. Montage

AVERTISSEMENT

L'assemblage DOIT être effectué par une personne compétente.

Toutes les fonctions DOIVENT être testées et approuvées par une personne compétente après l'assemblage.

Le montage DOIT avoir lieu dans un endroit clair et dégagé ; les enfants et les animaux domestiques doivent être tenus à l'écart.


Seule l'alimentation électrique fournie avec le lit peut être utilisée.

Si la barre d'assistance à levier a été souillée ou contaminée pendant le transport, reportez-vous aux instructions de nettoyage et de désinfection.

Assurez-vous que la tête et le pied de lit sont assemblés comme indiqué ci-dessous afin que la fonction Trendelenburg fonctionne de manière sécurisée.

1. Vérifiez que la livraison est complète et que le lit n'a subi aucun dommage visible pendant le transport.


2. Identifiez tous les composants :

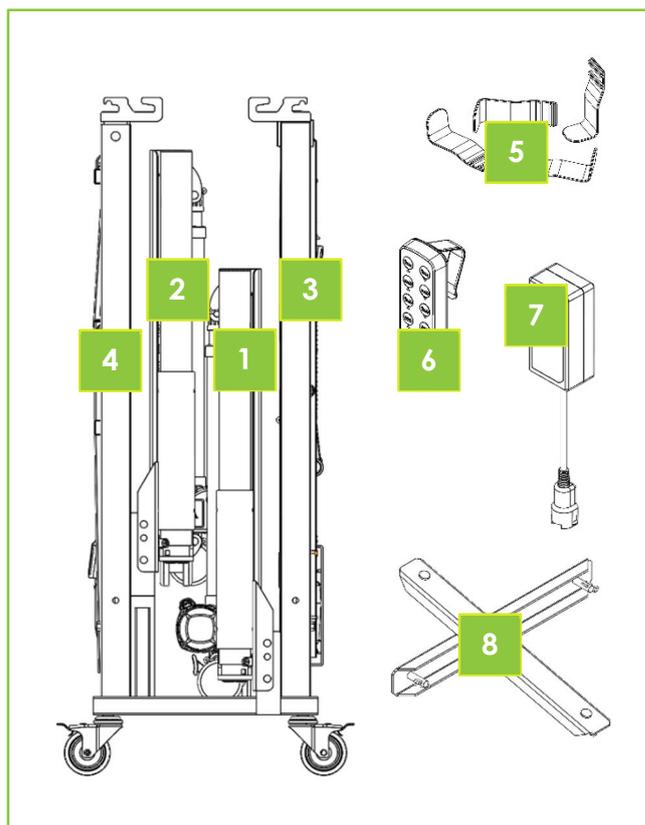


- 1 Tête de lit
- 2 Pied de lit
- 3 Sommier, côté tête
- 4 Sommier, côté pied
- 5 Guides de matelas
- 6 Télécommande
- 7 Alimentation électrique
- 8 Barres d'assemblage pour sommier

3. Assurez-vous que les roulettes du support de transport sont positionnées et verrouillées comme indiqué ci-dessous. Retirez les composants du support de transport dans l'ordre indiqué ci-dessous. Retirez les goupilles de verrouillage et desserrez les boulons (illustrés en rouge), un composant à la fois :

- A. Sommier, côté tête
- B. Sommier, côté pied
- C. Pied de lit
- D. Tête de lit

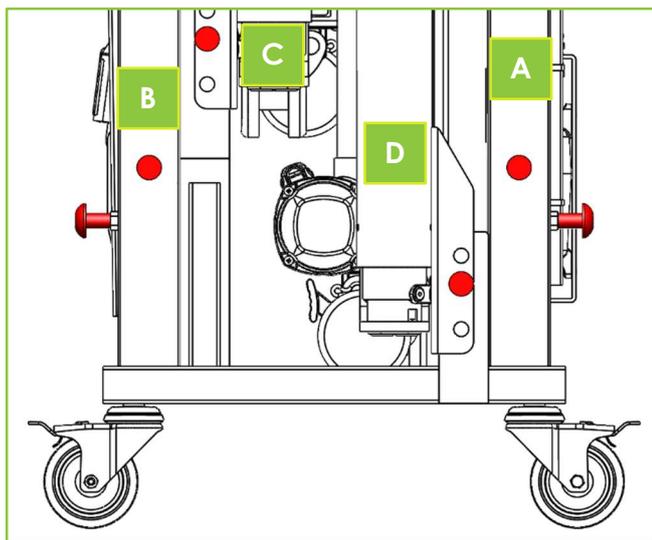


4. Assemblez la tête de lit et le sommier côté tête comme indiqué ci-dessous. Insérez la goupille de verrouillage et le clip R, comme indiqué, dans deux positions.

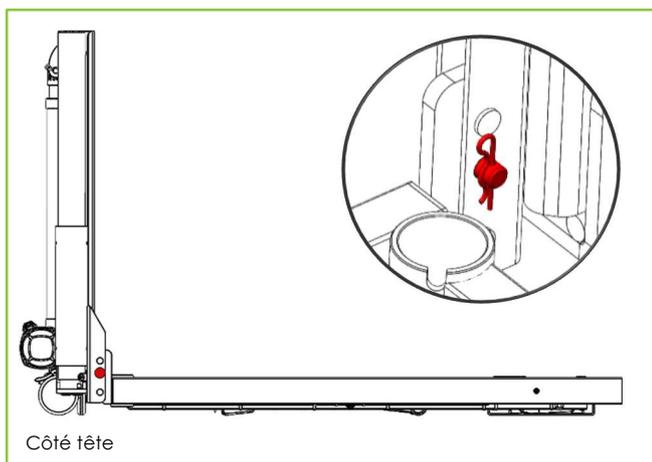


5. Assemblez le pied de lit et le sommier côté pied comme indiqué au 4 ci-dessus. Insérez la goupille de verrouillage et le clip R, comme indiqué, dans deux positions.


6. Insérez deux barres de jonction de sommier et fixez-les avec des goupilles de verrouillage et des clips R comme indiqué dans deux positions.

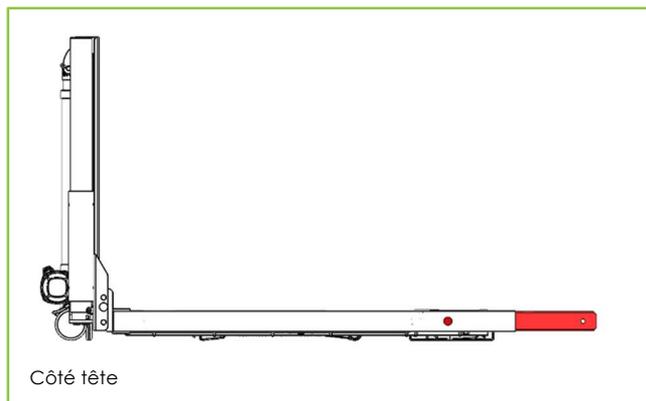


7. Assemblez les deux parties du lit à l'aide des barres de jonction et fixez-les avec des goupilles de verrouillage et des clips R comme indiqué dans deux positions.

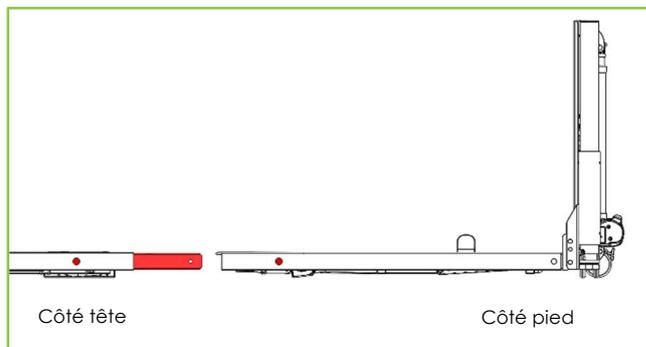


8. Le lit doit maintenant être assemblé avec 8 goupilles de verrouillage et des clips R situés, 4 de chaque côté, comme indiqué ci-dessous.

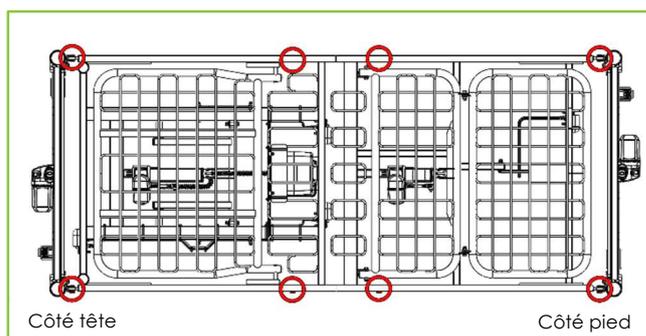


9. Voir la figure ci-dessous. Branchez les quatre câbles de l'actionneur (1) et installez le capuchon de protection coulissant (2) sur chaque connecteur de câble.

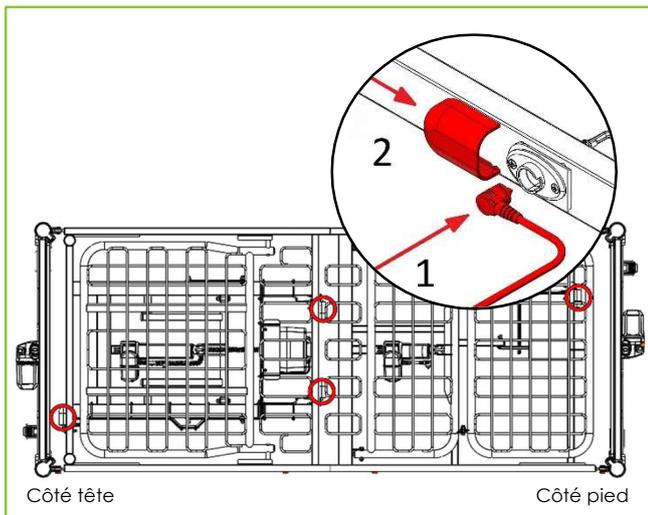

10. Inspectez tous les câblages pour détecter tout dommage ou risque d'écrasement avant de brancher le câble d'alimentation dans le câble d'alimentation du lit (acheminé vers la tête de lit), puis l'alimentation dans une prise secteur.
11. Retirez les attaches de transport rouges du repose-jambes et du dossier pour permettre la libre circulation des sections de profilage. Conservez pour une utilisation ultérieure.
12. À l'aide de la télécommande, soulevez le sommier d'environ 30 cm. Serrez quatre vis de blocage sous le sommier à l'aide d'une clé Allen de 5 mm, comme indiqué.

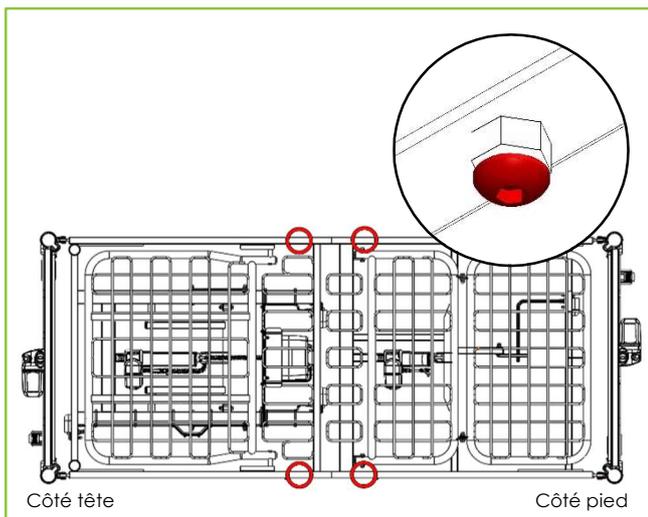

13. Montez les guides de matelas en position comme indiqué ci-dessous. Sélectionnez la fente de montage par largeur de matelas :
1. 850 mm/33,5 pouces
 2. 900 mm/35,5 pouces
 3. 915 mm/36,0 pouces

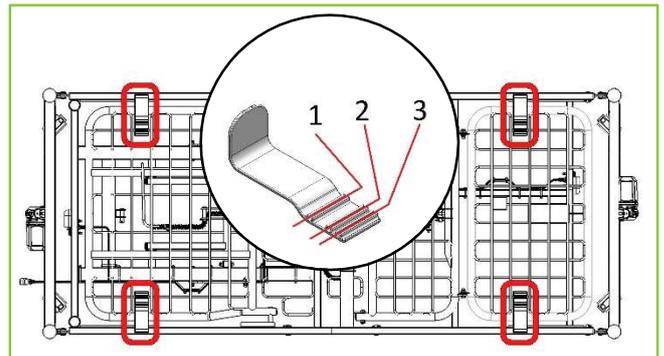

14. **Remarque** – Si le patient est un enfant dont la taille est inférieure à 1,55 m, le manchon de sécurité et les pare-chocs pour tête et pied de lit doivent être montés. Reportez-vous aux instructions de montage détaillées dans le manuel d'instruction de chaque accessoire.

9. Commandes et indicateurs du lit

AVERTISSEMENT

L'utilisation de la fonction repose-jambes doit être évaluée en fonction des risques car elle peut provoquer un déplacement involontaire lorsqu'elle est utilisée avec des patients de petite taille.

Partager le lit avec un patient (en particulier un enfant) comporte le risque de s'allonger sur le patient et de provoquer l'étouffement ou l'écrasement du patient contre le bord du lit.

L'utilisation de cales, de dispositifs de support et de positionnement peut piéger le patient et provoquer un risque d'étouffement.

Les patients plus petits peuvent avoir besoin d'un soutien supplémentaire pour atteindre la position de semi-fowler.

Le positionnement du lit DOIT être effectué par une personne compétente.

Assurez-vous de l'absence d'objets obstruants autour, au-dessus et en dessous du cadre du lit et positionnez le lit de manière à ce qu'il puisse fonctionner sur toute la hauteur sans que le patient ne soit coincé dans le mécanisme.

La tête du lit doit être à au moins 30 cm du mur. Serrez toujours les freins lorsque le lit est immobile ou laissé sans surveillance.

Les patients ne doivent être autorisés à faire fonctionner le lit de manière indépendante que s'ils sont capables de comprendre les consignes de sécurité de ce manuel et s'ils ont subi une évaluation des risques appropriée pour ce faire.

AVERTISSEMENT

Rangez toujours la télécommande dans un endroit sûr lorsqu'elle n'est pas utilisée pour éviter tout risque d'étranglement et éviter que le patient ne se coince dans le mécanisme du lit.

Si le patient est un enfant et que le pare-chocs avec une poche est monté, la télécommande doit être verrouillée et rangée dans la poche lorsqu'elle n'est pas utilisée.

La télécommande et le câble doivent être tenus hors de portée des enfants.


Assurez-vous que les freins des roulettes sont en position verrouillée avant d'utiliser la télécommande pour modifier les positions du lit.

La télécommande est utilisée par l'utilisateur ou le personnel soignant pour modifier la position des sections du dossier et du repose-jambes et pour régler la hauteur du sommier. Vérifiez toujours qu'il n'y a pas d'obstruction avant de lever ou d'abaisser le lit. Avant d'utiliser la télécommande, le personnel opérateur doit expliquer au patient comment le lit peut être positionné. Si le personnel médical déclare que l'état de santé du patient ne permet pas au patient d'ajuster le lit de manière autonome, la position du lit doit être ajustée uniquement par le personnel soignant.

Rangez toujours la télécommande dans un endroit sûr lorsqu'elle n'est pas utilisée pour éviter tout risque d'étranglement et éviter que le patient ne se coince dans le mécanisme du lit. Par exemple, à l'extérieur de la tête de lit ou du pied de lit.

Si le patient est un enfant, le pare-chocs pour tête et pied de lit avec une poche verrouillable doit être installé. Lorsqu'il n'est pas utilisé, la télécommande doit être verrouillée et rangée dans la poche. La fermeture éclair de la poche doit être fermée et sécurisée avec un cadenas. Reportez-vous au manuel d'instructions du pare-chocs pour tête et pied de lit.

La télécommande dispose des commandes et indicateurs suivants :

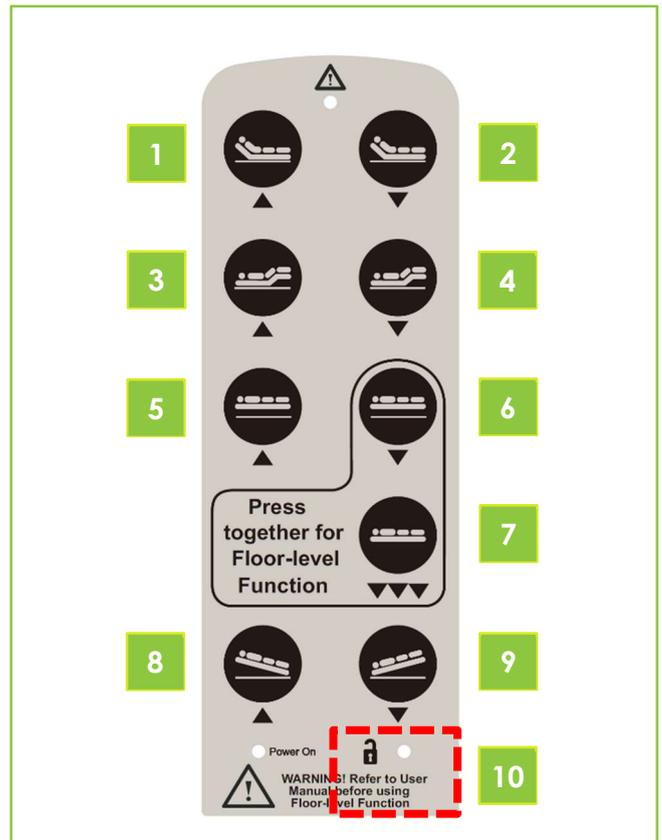

- | | | |
|----|---|--|
| 1 | 2 | Dossier – Monter / Abaisser |
| 3 | 4 | Repose-jambes – Monter / Abaisser |
| 5 | 6 | Lit - Monter/Abaisser |
| 7 | | Bouton de sécurité pour la fonction « sol » (doit être appuyé avec le bouton numéro six) |
| 8 | 9 | Fonction Trendelenburg inverse et Trendelenburg |
| 10 | | Indicateur de zone de balayage/verrouillage de la clé de sécurité |

Le voyant Power On de la télécommande s'allume en ORANGE lorsque le lit est branché sur une prise secteur et allumé. Lorsque l'appareil est mis sous tension pour la première fois et que le voyant Power On s'allume, la télécommande est en mode « Locked Out ». Le voyant de verrouillage (10) ne s'allume pas et toutes les fonctions sont verrouillées.

Les fonctions peuvent être déverrouillées à l'aide de la clé de sécurité. Cette clé peut être trouvée fixée au câble de la télécommande. Pour activer la télécommande, la clé de sécurité doit être glissée sur la partie inférieure de la

télécommande, comme le montre la case rouge en pointillés sur le schéma. Il existe différents niveaux de fonctionnalité à déverrouiller en fonction du nombre de fois que la clé est glissée sur la télécommande. Les niveaux de fonctionnalité sont les suivants :

1. Premier balayage – L'indicateur de verrouillage de la télécommande s'allume en VERT. Les boutons 1 à 8 seront activés, qui comprennent le dossier, le repose-jambes, la fonction « sol » et la fonction Trendelenburg inverse.
REMARQUE : La fonction Trendelenburg (bouton 9) restera verrouillée.
2. Deuxième balayage – L'indicateur de verrouillage de la télécommande s'allume en ORANGE. Les 9 boutons seront désormais activés, y compris Trendelenburg. Si la télécommande n'est pas utilisée, elle se verrouillera automatiquement après une durée prédéfinie. L'indicateur de verrouillage de la télécommande s'éteint et toutes les fonctions sont verrouillées.
3. Troisième balayage – L'indicateur d'état de verrouillage de la télécommande ne sera pas allumé. La télécommande est maintenant complètement verrouillée.

Remarque : Si le patient est incapable d'utiliser le lit en toute sécurité, verrouillez la télécommande à l'aide de la clé de sécurité immédiatement après chaque utilisation. (La clé de sécurité peut devoir être balayée deux fois pour verrouiller complètement. Voir les points 1 à 3 ci-dessus. Le verrouillage complet est confirmé par la mise hors tension de l'indicateur de verrouillage)

Position d'arrêt de sécurité - La position d'arrêt de sécurité est la position dans laquelle le lit s'arrêtera lors de l'abaissement du lit à l'aide du bouton 6. La hauteur du sommier sera d'environ 20 cm. Pour baisser le lit au niveau du sol, reportez-vous à la section 10.

10. Fonction « sol »

AVERTISSEMENT

Des précautions extrêmes doivent être prises lorsque le lit est au niveau du sol.

Assurez-vous que le patient ne peut pas se coincer dans le mécanisme du lit et qu'aucun objet obstruant ne se trouve sous le lit avant et pendant l'utilisation de la fonction « sol ».

Éloignez les enfants et les animaux domestiques du lit, à moins qu'ils ne soient supervisés par un adulte.

Les patients, les utilisateurs et les opérateurs doivent faire l'objet d'une évaluation des risques et être sensibilisés aux risques pour eux-mêmes et ceux qui les entourent avant l'utilisation de la fonction fonction « sol ».

Prenez garde à ne pas trébucher lorsque le lit est au niveau du sol.

La fonction « sol » abaissera le sommier au niveau du sol. Le sommier peut être abaissé à une hauteur de seulement 7,1 cm (2,8 pouces).

Position d'arrêt de sécurité – La position d'arrêt de sécurité est la position dans laquelle le lit s'arrêtera lors de l'abaissement du lit à l'aide du bouton 6. Pour abaisser le lit au niveau du sol, reportez-vous aux instructions ci-dessous :

Pour utiliser la fonction « sol » :

1. Vérifiez que le patient ne peut pas se coincer dans le mécanisme du lit et vérifiez sous le lit pour vous assurer de l'absence d'objets obstruants.
2. Lors de l'abaissement du lit, assurez-vous que l'utilisateur ou le patient garde les mains et les jambes éloignées du bord du matelas.
3. Déverrouillez la télécommande à l'aide de la clé.
4. Appuyez sur le bouton 6 pour abaisser le lit jusqu'à ce qu'il atteigne la position d'arrêt de sécurité (20 cm).
5. Appuyez simultanément sur les boutons 6 et 7. Le lit descendra maintenant jusqu'au niveau du sol.
REMARQUE : Si les deux boutons sont relâchés, le lit cessera de bouger immédiatement.
6. Lorsque le lit a atteint la hauteur souhaitée, verrouillez la télécommande et rangez-la dans un endroit sûr.

11. Contrôle des fonctionnalités

AVERTISSEMENT

Le contrôle de fonctionnalité DOIT être effectué par une personne compétente.

Assurez-vous de l'absence d'objets obstruants autour, au-dessus et en dessous du cadre du lit et positionnez le lit de manière à ce qu'il puisse fonctionner sur toute la hauteur sans risquer de piéger le patient dans ses mécanismes.

La tête du lit doit être à au moins 30 cm/11,8 pouces du mur. Serrez toujours les freins lorsque le lit est immobile ou laissé sans surveillance.

À l'aide de la télécommande, testez toutes les fonctions du lit et vérifiez qu'aucun des câbles n'est écrasé.


Reportez-vous à la section 8 :

1. Montez le lit à pleine hauteur (bouton 5)
2. Abaissez le lit jusqu'à ce qu'il s'arrête à la position d'arrêt de sécurité (bouton 6)
3. Utilisez l'action du double bouton de sécurité pour activer la fonction « sol » et abaisser le lit au niveau du sol (boutons 6 et 7 pressés ensemble)
4. Vérifiez qu'aucun des câbles n'est écrasé.
5. Montez et abaissez le dossier (boutons 1 et 2)
6. Montez et abaissez le repose-jambes (boutons 3 et 4)
7. Vérifiez la fonction Trendelenburg inverse (tête en haut, pieds en bas) (bouton 9). La fonction Trendelenburg (tête vers le bas, pieds vers le haut) (bouton 9) ne doit pas s'activer à moins que cette fonction ne soit déverrouillée comme décrit dans la section 9.


Vérifiez le bon fonctionnement des roulettes et de la commande de frein. Vérifiez toutes les fonctions de la télécommande.

12. Utilisation des freins des roulettes

Les quatre roulettes peuvent être verrouillées en appuyant sur le levier inférieur des roulettes ; elles peuvent ensuite être déverrouillées en appuyant sur le levier supérieur des roulettes. Il faut veiller à ce que les freins des roulettes soient toujours verrouillés lorsque le lit est en cours d'utilisation, en cours de montage ou de démontage, afin que le lit ne bouge pas accidentellement.



Frein verrouillé



Frein déverrouillé


13. Sélection de matelas

AVERTISSEMENT

Des matelas incompatibles peuvent créer des dangers. Lisez les instructions d'utilisation.

Lorsqu'un matelas spécial ou un surmatelas est utilisé et que la distance entre le haut du matelas non comprimé et le haut de la barrière, le cas échéant, est inférieure à 220 mm/8,7 pouces, une évaluation des risques doit être effectuée pour assurer une sécurité équivalente.

L'extension du lit DOIT être effectuée par une personne compétente et la pièce de remplissage appropriée doit être utilisée. Le non-respect de cette obligation entraînera des lacunes inacceptables et des risques de blessures. De plus, le patient pour se coincer dans le mécanisme du lit.



Veillez contacter Accora pour les matelas compatibles.

Des matelas incompatibles

Tous les matelas doivent être installés et utilisés conformément aux instructions du fabricant ou du fournisseur du matelas.

Numéro de modèle	NSB-0-FL2-200
Taille du matelas - Configuration Standard	2000 x 900 mm 78,7 x 35,4 pouces
Taille du matelas - Configuration étendue *	2200 x 900 mm 86,6 x 35,4 pouces
Référence de l'extension du sommier	LRPEX-0-FL1-100

* La pièce de remplissage d'extension de sommier DOIT être utilisée si le sommier est étendu.

14. Sélection des barrières latérales

AVERTISSEMENT

N'utilisez que des barrières latérales et autres accessoires fournis par Accora et compatibles avec ce lit.

Des barrières incompatibles peuvent créer des dangers.

Les barrières latérales sont disponibles auprès d'Accora pour le FloorBed 2. Avant de monter ou d'utiliser les barrières latérales du FloorBed 2, vous devez vous référer au manuel d'instructions IFU-FL2-003EN des barrières latérales.

15. Démontage

AVERTISSEMENT

Le démontage DOIT être effectué par une personne compétente.

Le lit doit être déconnecté de l'alimentation électrique avant le démontage.

Le montage doit avoir lieu dans un endroit clair et dégagé ; les enfants et les animaux domestiques doivent être tenus à l'écart.

Si la barre d'assistance à levier a été abîmée ou contaminée pendant l'utilisation, reportez-vous aux instructions de nettoyage et de désinfection.

Une extrême prudence doit être prise lors du déplacement du lit sur le support de transport pour éviter que le lit ne bascule ou ne bouge de manière inattendue.

Ne déplacez pas le lit lorsque l'alimentation est branchée sur la prise secteur.

1. Retirez tous les accessoires, par exemple le matelas, les barrières latérales, les leviers de lit, etc.
2. À l'aide de la télécommande, soulevez le sommier d'environ 30 cm. Desserrez les 4 vis de verrouillage de la barre de jonction du sommier. (Ne retirez pas les clips R et les goupilles de verrouillage à ce stade)
3. Fixez le dossier et le repose-jambes en position horizontale avec les attaches de transport rouges fournies.

4. Abaissez le sommier au niveau du sol et débranchez l'alimentation électrique.
5. Retirez les couvercles coulissants de la fiche de l'actionneur et débranchez 4 actionneurs. Remplacez les couvercles coulissants. Assurez-vous que les câbles desserrés sont fixés pour éviter tout dommage pendant le transport.
6. Retirez les clips R de la barre de jonction centrale et les goupilles de verrouillage et séparez le lit en deux moitiés.
7. Démontez la tête de lit/le sommier côté tête et le pied de lit/le sommier côté pied en retirant les clips R et les goupilles de verrouillage.
8. Assurez-vous que les pièces démontées sont montées sur le support de transport dans l'ordre suivant et positionnées comme indiqué dans la section 8 :

1. Tête de lit (D dans la section 8)
2. Pied de lit (C dans la section 8)
3. Sommier, pied de lit (B dans la section 8)
4. Sommier, côté tête (A dans la section 8)
5. Assurez-vous que tous les clips R et les goupilles sont remontés afin que le lit sur le support de transport puisse être déplacé en toute sécurité.
6. Assurez-vous que tous les fils sont fixés pour éviter tout dommage.

16. Déplacement et repositionnement

AVERTISSEMENT

Le déplacement ou le repositionnement DOIT être effectué par une personne compétente.

Toutes les fonctions DOIVENT être testées et approuvées par une personne compétente après déplacement ou repositionnement.

Seule l'alimentation électrique fournie avec le lit peut être utilisée.

Ne déplacez pas le lit lorsqu'il est au niveau du sol.

Ne déplacez pas ou ne repositionnez pas le lit lorsque l'utilisateur ou le patient est dans le lit.

Ne déplacez pas le lit lorsque l'alimentation est branchée sur la prise secteur.

1. Assurez-vous que le lit est en position d'arrêt de sécurité (voir les sections 9 et 10).
2. Débranchez l'alimentation.
3. Sécurisez la télécommande, l'alimentation et l'ensemble des câbles pour éviter tout dommage.
4. Déverrouillez les roulettes et déplacez le lit.
5. Lorsque le lit a été déplacé ou repositionné, verrouillez toutes les roulettes comme décrit à la section 12 et effectuez un contrôle complet des fonctionnalités comme décrit à la section 11.

17. Nettoyage et désinfection

AVERTISSEMENT

Le nettoyage et la désinfection DOIVENT être effectués par une personne compétente.

Le lit doit être déconnecté de l'alimentation électrique lorsqu'il est nettoyé ou désinfecté.

Toutes les fonctions DOIVENT être testées et approuvées par une personne compétente après le nettoyage ou la désinfection.

Le lit et les accessoires DOIVENT être nettoyés et désinfectés avant de réutiliser le lit pour un autre patient.

Informations relatives au nettoyage :

Pour désinfecter le lit, utilisez uniquement des détergents conçus pour un usage médical. N'utilisez pas d'abrasifs, d'éponges à récurer ou d'autres matériaux qui pourraient endommager le revêtement. N'utilisez pas de produits corrosifs, caustiques ou acides puissants.

Ne pas utiliser de détergents qui pourraient altérer la structure ou le comportement des plastiques (essence etc.).

Nettoyez en essuyant avec un chiffon humide.

Le lit n'est pas conçu pour l'entretien dans les lave-lits automatiques ou pour le nettoyage à l'eau sous pression, au jet, à la douche ou à la vapeur.

Accora ne peut être tenu responsable de quelconque dommage ou risque de dommage en cas d'utilisation d'agents nettoyants ou désinfectants inappropriés.

Procédure de nettoyage :

1. Retirez tous les accessoires, matelas, etc.
2. Réglez le sommier en position levée et ajustez la position du dossier et du repose-jambes pour permettre l'accès pour le nettoyage de toutes les pièces du sommier.
3. Débranchez le lit de l'alimentation électrique.
4. Déplacez le lit à l'endroit où le nettoyage aura lieu et verrouillez les roulettes du lit.
5. Nettoyez comme décrit dans les « Informations de nettoyage ».

18. Dépannage

AVERTISSEMENT

Le dépannage DOIT être effectué par une personne compétente.

N'essayez pas d'ouvrir les boîtiers des pièces électriques.

N'essayez pas de réparer des pièces électriques.

Toutes les fonctions DOIVENT être testées et approuvées par une personne compétente après le dépannage

Le FloorBed 2 ne fonctionne pas correctement :

1. Le voyant « Power on » de la télécommande est-il allumé ? Si le voyant n'est pas allumé :
 - a. L'alimentation électrique est-elle branchée et allumée ?
 - b. Le cordon d'alimentation de la prise en ligne est-il branché correctement ?
 - c. Si le voyant « Power on » n'est toujours pas allumé, contactez Accora pour obtenir de plus amples conseils.
2. Si le voyant « Power on » est allumé, la télécommande a-t-elle été déverrouillée ? Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la section 9.
3. Si la télécommande a été déverrouillée et que le FloorBed ne fonctionne toujours pas correctement, contactez Accora pour obtenir de plus amples conseils.

Si le FloorBed ne s'arrête pas à la position d'arrêt de sécurité, vérifiez que les actionneurs de levage principaux sont correctement branchés en tous points entre l'actionneur et le boîtier de commande.

Si le FloorBed ne fonctionne toujours pas correctement, contactez Accora pour plus de conseils.

19. Stockage

Nos recommandations pour un stockage sans problème :

1. Débranchez le lit de l'alimentation électrique
2. Refaites les accessoires
3. Emballez les accessoires ou couvrez-les de manière à ne pas endommager le revêtement et les pièces en plastique
4. Le lit doit être conservé à une température comprise entre
- 20°C à + 50°C, - 4°F à + 122°F
5. Le lit doit être stocké dans une humidité relative (sans condensation) comprise entre 30 % et 75 %.

20. Inspection quotidienne

Une inspection visuelle quotidienne est fortement recommandée et peut être effectuée par le personnel soignant, l'utilisateur ou une autre personne.

Les contrôles suivants doivent être effectués :

1. Le lit fonctionne-t-il conformément aux attentes sans bruit ni mouvement inattendu ?
2. Y a-t-il des signes de mauvaise utilisation ou d'usure excessive ?
3. Tous les appareils et accessoires sont-ils bien serrés et sécurisés ?
4. Le cadre de lit semble-t-il stable et sécurisé ?

5. Tous les accessoires sont-ils installés conformément aux instructions du fabricant ou du fournisseur d'accessoires ?
6. Tous les freins des roulettes sont-ils en position verrouillée ?
7. Tous les câbles électriques (y compris les accessoires, par ex. la pompe à air du matelas) sont-ils fixés et rangés pour éviter les dommages ?
8. La fonction de verrouillage de la télécommande fonctionne-t-elle correctement ? (voir section 9).
9. Le lit s'arrête-t-il à la position d'arrêt de sécurité ? (Voir les sections 9 et 10)
10. La zone autour, au-dessus et en-dessous du lit est-elle libre de toute obstruction possible ?
11. Y a-t-il un risque que le patient soit coincé ou blessé ?
12. Des câbles électriques sont-ils pincés, écrasés ou endommagés de quelque façon que ce soit ?

Si un dommage, un problème de performance ou un motif d'inquiétude est constaté au cours de cette inspection, le lit doit être retiré du service et des mesures appropriées doivent être prises.

21. Entretien général

AVERTISSEMENT

L'entretien DOIT être effectué par une personne compétente.

Toutes les fonctions DOIVENT être testées et approuvées par une personne compétente après l'entretien. Voir la section 11.

Seule l'alimentation électrique fournie avec le lit peut être utilisée.

Ne procédez pas à l'entretien lorsque l'utilisateur du service ou le patient est dans le lit.

Pour plus d'informations sur le service et la réparation du FloorBed 1, reportez-vous au manuel de service, SER-FL1-001FR. Les réparations du FloorBed 1 doivent être effectuées par du personnel dûment formé et qualifié.

22. Garantie

Numéro de modèle	NSB-0-FL2-200
Période de garantie	2 ans

Si le lit a été acquis pour une maison de soins, le service d'entretien de la maison de soins doit contacter Accora pour obtenir les pièces nécessaires.

23. Élimination du FloorBed

En cas de mise au rebut des matériaux du lit, les pièces en fin de vie doivent être traitées conformément aux réglementations environnementales en vigueur.

24. Déclaration CEM

Directives et déclaration du fabricant - émissions électromagnétiques		
<p>Le dispositif est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique précisé ci-dessous.</p> <p>Le client ou l'utilisateur du lit doivent veiller à l'utiliser dans ce type d'environnement.</p>		
Test d'émission	Conformité	Environnement électromagnétique - conseils
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1	Le lit utilise l'énergie RF uniquement pour son fonctionnement interne. De ce fait, ses émissions RF sont très faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer des interférences avec les équipements électroniques situés à proximité.
Émissions RF CISPR 11	Classe B	Le lit peut être utilisé dans tous les établissements, y compris les établissements domestiques et ceux directement connectés au réseau public d'alimentation électrique à basse tension qui alimente les bâtiments à usage domestique.
Émissions harmoniques CEI 61000-3-2	Classe A	
Fluctuations de tension /émissions de scintillement CEI 61000-3-3	Conformité	

Directives et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique			
Le dispositif est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique précisé ci-dessous.			
Le client ou l'utilisateur du lit doivent veiller à l'utiliser dans ce type d'environnement.			
Test d'immunité	CEI 60601 IEC 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique - conseils
Décharge électrostatique (DES) CEI 61000-4-2	contact + 6 kV air + 8 kV	contact + 6 kV air + 8 kV	Le revêtement des sols doit être en bois, en béton ou en carreaux de céramique. Si les sols sont revêtus de matériaux synthétiques, l'humidité relative doit être d'au moins 30 %.
Salves transitoires/rafales électriques rapides CEI 61000-4-4	+ 2kV pour l'alimentation électrique lignes + 1 kV pour l'entrée/sortie lignes	+ 2kV pour l'alimentation électrique lignes Non applicable	La qualité de l'alimentation réseau doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique.
Surtension CEI 61000-4-5	+ 1kV ligne(s) à ligne(s) + 2kV ligne(s) à la terre	± 1 kV en mode différentiel Non applicable	La qualité de l'alimentation réseau doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique.
Creux de tension, interruptions courtes et variations de tension de l'alimentation électrique lignes d'entrée CEI 61000-4-11	< 5 % UT (> 95 % creux en UT) pour 0,5 cycle 40 % UT (60 % creux en UT) pour 5 cycles 70 % UT (30 % creux en UT) pour 25 cycles < 5 % UT (> 95 % creux en UT) pour 5s	< 5 % UT (> 95 % creux en UT) pour 0,5 cycle 40 % UT (60 % creux en UT) pour 5 cycles 70 % UT (30 % creux en UT) pour 25 cycles < 5 % UT (> 95 % creux en UT) pour 5s	La qualité de l'alimentation réseau doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique. Si l'utilisateur du lit a besoin d'un fonctionnement continu pendant les interruptions du réseau électrique, il est recommandé d'alimenter le lit à partir d'une alimentation sans coupure ou d'une batterie.
Fréquence d'alimentation (50/60 Hz) Champ magnétique CEI 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Les champs magnétiques de la fréquence d'alimentation doivent correspondre à ceux d'un environnement commercial ou hospitalier typique.
REMARQUE : UT est le voltage principal c.a. avant l'application du niveau de test.			

Directives et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique

Le dispositif est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique précisé ci-dessous.

Le client ou l'utilisateur du lit doit veiller à l'utiliser dans ce type d'environnement.

Test d'immunité	Test de niveau CEI 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique - conseils
RF par conduction CEI 61000-4-6	3 Vrms De 150 kHz à 80 MHz	3 Vrms	Les équipements de communication RF portables et mobiles ne doivent pas être utilisés plus près de toute partie du lit, y compris les câbles, que la distance de séparation recommandée calculée à partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur. Distance de séparation recommandée : $d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 1,2 \sqrt{P}$ 80MHz à 800 MHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ 800MHz à 2,5 GHz Où P est la puissance maximale de sortie en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur et d est la distance de séparation recommandée en mètres (m)
RF émise CEI 61000-4-3	3 V/m 80 MHz à 2,5 GHz	3 V/m	Les intensités de champ des émetteurs RF fixes, telles que déterminées par une étude électromagnétique du site a, doivent être inférieures au niveau de conformité dans chaque gamme de fréquences b. Des interférences peuvent se produire à proximité des équipements avec le symbole suivant : 

REMARQUE 1 : À 80 MHz et 800 MHz, la gamme de fréquences la plus élevée s'applique.

REMARQUE 2 : Ces consignes ne s'appliquent pas forcément à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, objets et personnes.

a	Les forces de champ des émetteurs fixes, comme les stations de base pour les radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et les radios mobiles terrestres, les radios amateurs, la diffusion radio AM et FM ainsi que la diffusion télé ne peuvent pas être théoriquement prévues avec précision. Pour évaluer l'environnement électromagnétique résultant de la présence d'émetteurs RF fixes, une étude électromagnétique sur site doit être envisagée. Si l'intensité de champ mesurée à l'endroit où le lit est utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, le lit doit être observé pour vérifier son fonctionnement normal. Si des performances anormales sont observées, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, comme la réorientation ou le déplacement du lit.
b	Dans la plage de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent être inférieures à 3 V/m.

Distance de séparation recommandée entre les équipements de communication RF portables et mobiles et le lit.

Le lit est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations de rayonnements RF sont contrôlées.

Le client ou l'utilisateur du lit peut contribuer à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et le lit, comme recommandé ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale de l'équipement de communication.

Puissance de sortie nominale maximale de l'émetteur Me	Distance de séparation en fonction de la fréquence de l'émetteur m		
	150 kHz à 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	80 MHz à 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	800 MHz à 2,5 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale n'est pas indiquée ci-dessus, la distance de séparation recommandée (d) en mètres (m) peut



être estimée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où p est la puissance de sortie maximale nominale de

l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur.

REMARQUE 1 : À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la gamme de fréquences supérieure s'applique.

REMARQUE 2 : Ces consignes ne s'appliquent pas forcément à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, objets et personnes.

25. Tableau des symboles

	Avertissement, attention aux dangers potentiels – se reporter au manuel d'instructions		Avertissement, fonction « sol » et tenir à l'écart des obstructions
	Se reporter au manuel d'instructions		Avertissement concernant la fonction « sol »
	Conforme au Règlement européen sur les dispositifs médicaux 2017/745		Assurez-vous que les barrières latérales sont compatibles avec le lit avant le montage
	Numéro de modèle		Avertissement, poids supérieur à 20 kg (44 lb)
	Numéro de série		Label en attente de brevet
	Charge de travail de sécurité (CTS) - Poids maximum que le lit peut supporter en toute sécurité, y compris le patient, le matelas et les accessoires installés		Dispositif médical conforme au Règlement européen sur les dispositifs médicaux 2017/745
	Poids maximal du patient		Pied de lit
	Date de fabrication		Tête de lit
	Fabricant		Description physique d'un adulte
	Attention, n'utilisez que des matelas compatibles		Label d'identification unique des dispositifs (IUD)
	Représentant pour l'UE		

26. Coordonnées

	Royaume-Uni et reste du monde	États-Unis
Adresse :	Accora Ltd. Charter House Barrington Road Orwell Cambridge SG8 5QP Royaume-Uni	Accora Inc. 9210 Corporate Blvd. Suite 120 Rockville MD 20850 États-Unis
Téléphone	+44 (0)1223 206100	+1 301-560-2400
E-mail	info@accora.care	information@accora.care
Site internet	www.accora.care	www.accora.care

Accora



Accora
Barrington Road
Orwell
Cambridge
SG8 5QP
Royaume-Uni

T : +44 (0)1223 206100
info@accora.care
www.accora.care